HIMSA
Hearing Instrument Manufacturers' Software Association
news
Juin 2009

NOAH 3 peut-il le faire ?

De Sue Falkingham, Audiologue chez HIMSA

Chez HIMSA on nous pose souvent des questions sur les fonctionnalités du logiciel qui demeurent inconnues de la majorité des utilisateurs. Je profiterai des prochaines lettres d'information pour m'attarder sur certaines de ces fonctionnalités et pour vous guider vers votre manuel d'utilisation pour plus d'informations détaillées de chaque domaine. Vous trouverez le manuel d'utilisation de NOAH sur votre ordinateur en cliquant sur Démarrer, Tous les programmes, NOAH System et Documentation.

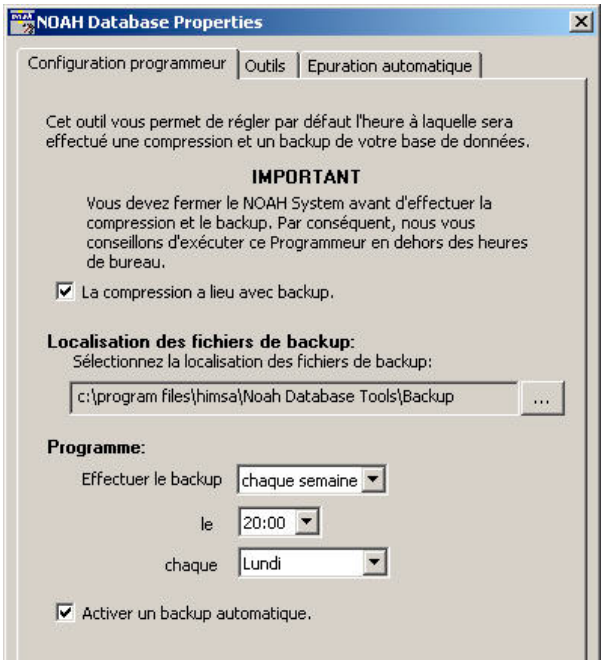
NOAH Database Properties
Configuration programmeur
Outils
Epuration automatique
Cet outil vous permet de régler par défaut l'heure à laquelle sera effectué une compression et un backup de votre base de données.
IMPORTANT
Vous devez fermer le NOAH System avant d'effectuer la compression et le backup. Par conséquent, nous vous conseillons d'exécuter ce Programmeur en dehors des heures de bureau.
La compression a lieu avec backup.
Localisation des fichiers de backup:
Sélectionnez la localisation des fichiers de backup:
c:\program files\himsa\Noah Database Tools\Backup
...
Programme:
Effectuer le backup
chaque semaine
le
20:00
chaque
Lundi
Activer un backup automatique.

automatique régulier de votre base de données NOAH, mais n'oubliez pas de programmer ce back-up après vos heures d'ouverture étant donné que le processus de back-up pourrait ralentir le système.

D'autre part, l'ordinateur doit être allumé au moment où vous choisissez d'effectuer le back-up.

Pour plus de détails sur la façon de configurer un back-up de NOAH, consultez la page 6-20 du guide de l'utilisateur de NOAH, *Automatiser le back-up de la base de données*.

(suite page 2)

Pour éviter le pire – une solution facile

Nous savons tous qu'il est capital de faire un back-up des données, mais trop fréquemment cela est négligé jusqu'à ce que le pire se produise. Pour cette même raison, le logiciel NOAH possède un système de back-up automatisé de vos données, installé en dehors de NOAH.

Sue Falkingham – Audiologue chez HIMSA

Quelques astuces pour effectuer un back-up de NOAH

Effectuer un back-up du système régulièrement : HIMSA vous suggère d'effectuer au moins un back-up hebdomadaire afin de ne jamais perdre moins d'une semaine de données.

Automatiser le processus de back-up, mais veiller à ce qu'il fonctionne correctement en recherchant le fichier de back-up créé. Placer le back-up ailleurs que sur votre propre ordinateur : par exemple sur un disque amovible, disque USB ou disque dur externe.

Vous pouvez installer un back-up

Pour recevoir cette lettre d'information par mail, veuillez vous abonner sur notre site internet www.himsa.com.

A l'intérieur

3 **HIMSA souhaite la bienvenue à trois nouveaux membres**

4 **Le coin support: Bluetooth NOAHlink**

NOAH 3 peut-il le faire ? *(suite)*

Quelques clics suffisent pour sécuriser vos données

Vous n'avez pas besoin de grande connaissance en informatique pour protéger les données de vos patients. Le logiciel NOAH propose un système de sécurité à mot de passe simple mais d'une très grande efficacité. Vous pouvez ajouter un nouvel utilisateur à votre système, choisir entre 2 niveaux personnalisés d'accès de sécurité pour chaque utilisateur et gérer les réglages du mot de passe de votre système. Jetez un œil au système en cliquant sur *Outils* et *Administration utilisateurs* dans votre logiciel NOAH. Pour plus d'information, veuillez consulter la page 6-4 de votre manuel d'utilisation de NOAH.

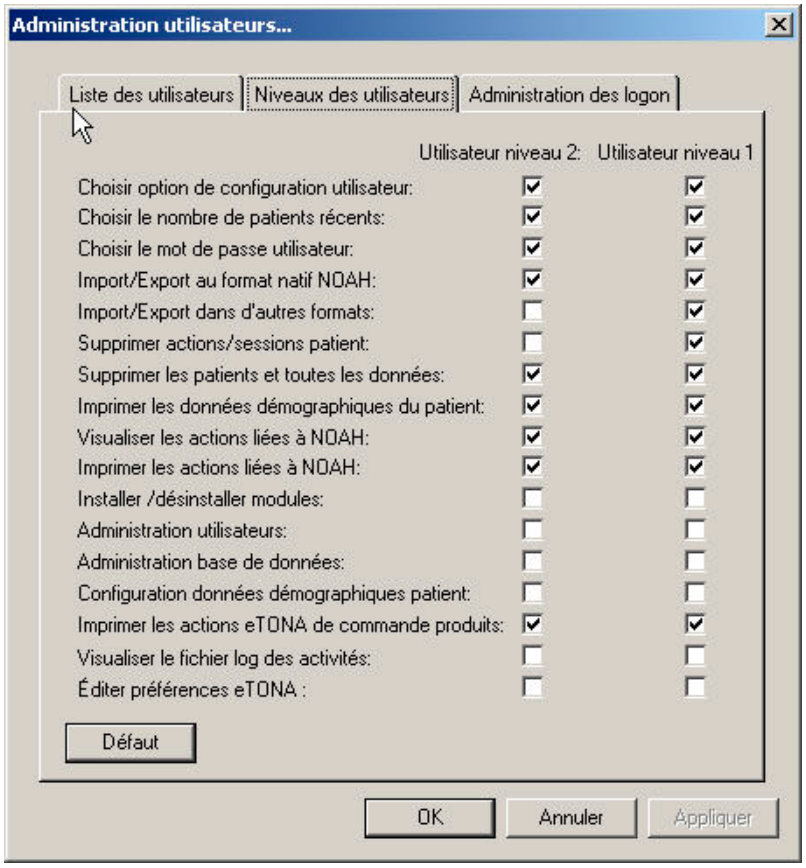

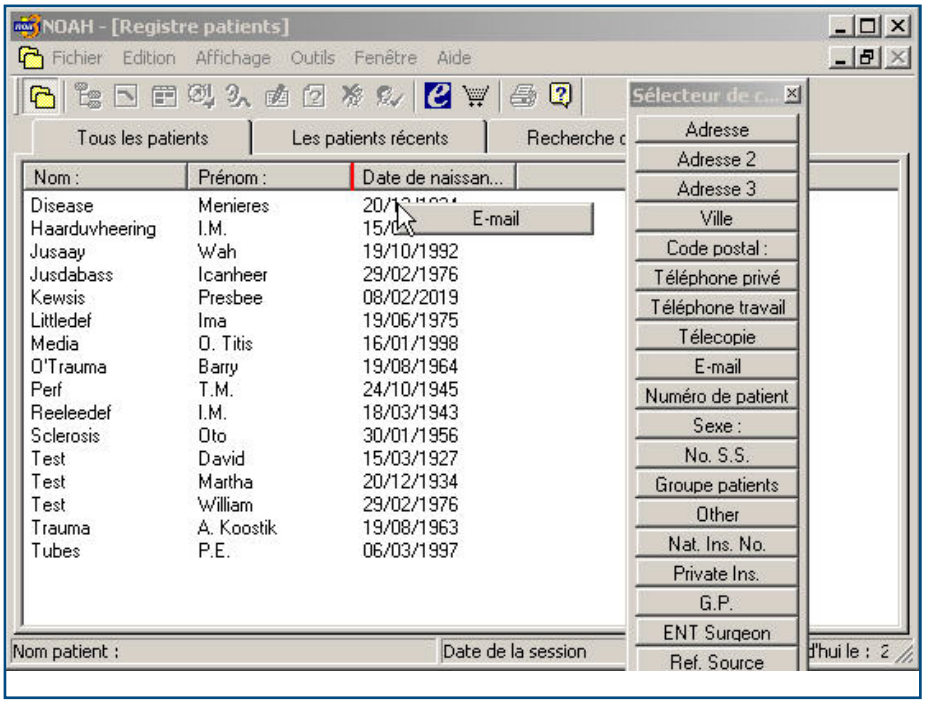

Trier les dossiers de vos patients

Ne serait-ce pas formidable si le *Registre patients* de NOAH affichait les informations patient que vous voulez, dans l'ordre où vous voulez? Et bien, c'est possible. Sur l'écran du *Registre patients*, un outil simple, appelé le Field Chooser, vous permet de sélectionner les champs que vous souhaitez voir sur cet affichage. Cela vous permet de trier à partir de n'importe quel champ se trouvant sur l'affichage, ce qui facilite la recherche d'un patient dans votre système. Les titres des colonnes sur cet écran peuvent être réorganisés par une action glisser-déposer et triés en cliquant sur le titre de la colonne. Vous trouverez davantage d'information sur le *Registre patients* à la page 1-19 du manuel d'utilisation.

HIMSA souhaite la bienvenue à trois nouveaux membres

HIMSA compte désormais un total de 88 sociétés membres

HIMSA a le plaisir de souhaiter la bienvenue à trois nouvelles sociétés membres de son association.

CounselEAR, LLC (*www.counselear.com*) a été créée en 2006 dans le but délibéré d'améliorer le counselling auprès des patients. CounselEAR reconnait qu'un patient à qui ont a apporté un counselling oral ne se souvient pas des informations importantes et n'applique pas les recommandations. Pour y remédier, ils ont créé une méthode de génération rapide de rapports personnalisés qui aide considérablement le patient à se rappeler et à se conformer aux conseils.

Suite au lancement du Rapport patient CounselEAR, ils ont créé le Rapport professionnel CounselEAR afin de pouvoir offrir rapidement des rapports audiologiques officiels, ainsi que des couvertures de fax et de lettres.

Otonix (*www.otonix.org*) est un leader industriel dans l'apport de solutions logicielles complètes et de gestion des services en audiologie. Créée en 2004, Otonix peut se prévaloir d'une grande expérience en matière d'innovation et de croissance. Le but d'Otonix est d'aider ses clients à accroître leur minimum et de générer davantage de trafic dans leurs magasins. Otonix propose une grande diversité de solutions destinées aux oto-rhino-laryngologistes et aux entreprises.

Au travers d'Otonix, des sociétés de toutes tailles peuvent proposer un solide canal de distribution pour les aides auditives tout en réduisant les frais généraux et en améliorant la performance, et de plus en répondant en même temps aux besoins en constante mutation de la branche.

Special Data Systems (*www.practiceexplorer.net*) conçoit, développe et supporte des logiciels de gestion bureautique pour les audioprothésistes depuis plus de 20 ans.

Leur nouveau produit sur le marché de l'audioprothèse, Practice Explorer, apporte avec lui un savoir cumulatif des meilleures pratiques de gestion des bureaux de taille différente, qu'il s'agisse d'audioprothésistes seuls ou de grands services d'audiologie de centres hospitaliers.

L'objectif est de proposer un logiciel stable, efficace, expansible et facile à utiliser.

Leur approche est de proposer un logiciel qui peut s'accroître avec les changements apportés au hardware et avec les exigences de l'industrie de l'audioprothèse. Practice Explorer sera peut-être le dernier logiciel de gestion bureautique que vous devrez acquérir.

Aujourd'hui, près de 90 sociétés supportent le logiciel NOAH standard. Quasiment la moitié de ces sociétés sont des fabricants d'aides auditives représentant une part de marché d'environ 90 pourcent. Soit ces fabricants possèdent des logiciels compatibles avec NOAH, soit ils envisagent d'en lancer un prochainement.

Si vous souhaitez une liste complète des sociétés membres d'HIMSA, veuillez consulter notre site internet sur *www.himsa.com/Default.aspx?tabid=81*.

Les produits certifiés pour NOAH 3

La liste ci-dessous est une liste de produits NOAH 3, certifiés au 23 juin 2009. Si vous souhaitez une liste complète des produits actuellement certifiés, veuillez consulter le site internet de HIMSA:

** Certifié pour NOAHlink

** Certifié pour Windows Vista

Modules d'adaptation NOAH 3:

Argosy Professional Fitting Guideline 8.6a **
Argosy iPFG 2.2 **,**
Argosy Fitting System 4.0
Audifon Audifit 4.3 **,**
Audina ezFIT 4.16
Authorized Hearing Systems QuikFit 3.8.3
Beltone Selectafit 4.2b
Beltone Solus 2.6 **,**
Bernafon AHS Oasis 3.65f
Bernafon Oasis Plus 10.0.3.62 **,**
Cochlear Baha Fitting Software 1.0 **,**
Coselgi Amadeus 4.1 **,**
GN ReSound Audifit 1.30 **
GN ReSound Aventa 2.8 **,**
GN ReSound Danfit 4.30g
GN ReSound Resource II 1.6
Interton CompuFit 4.4 **,**
Interton Appraise 1.30.11.3 **,**
Magnatone DigiPro 6.05.09
Micro-Tech Meridian 5.5.35 **
Oticon Genie 2009.1SP1 **,**
Oticon Otiset 5.1
Phonak Fitting Guideline 8.6b **
Phonak iPFG 2.4a **,**
SeboTek Fitting Software 4.8 (0507) **,**
Siemens CONNEXX 6.2.0.1699 **,**
SONIC Innovations Expressfit 6.0.2 **,**
Starkey PFS, NuEar, Omni, Qualitone 4.5.309 **
Starkey Inspire OS (AudioSync, Audibel, Micro Tech , NuEar, Omni, Qualitone) 4.0 **,**
Unitron U Fit 2.01 **,**
Unitron Unifit 5.51 **
Vivatone Vivaset 2.2.0.79 **,**
Widex COMPASS 4.7 **,**

Modules eTONA:

Siemens eForms 4.1.0.1471
Siemens Order Creation Module 3.3.1.742
Starkey Inspire OS 4.0 **,**

Modules de mesures:

Bertges EAR 2.0
Frye Electronics Fonix for NOAH 1.23
Frye Fonix Technicians Module 1.0
GN Otometrics OTOsuite 3.20.11.02 **
Grason-Stadler GSI Audio Tymp 1.0
Interacoustics AC440 1.08
Interacoustics REM440 1.09
Interacoustics Affinity HIT 1.0
Interacoustics IA-NOAH-AUD 1.16
Interacoustics IA-NOAH-IMP 1.07
Interacoustics IA-NOAH-REM 1.08
Madsen/Otometrics AURICAL plus Aud 4.0.3.0219 **
Madsen/Otometrics Conera Aud 4.0.3.0219 **
Madsen/Otometrics AURICAL plus REM 4.1.1.0135 **
Madsen/Otometrics AURICAL plus HIT 4.1.0130 **
Madsen/Otometrics Capella 2.12 **
Madsen/Otometrics OtoCam 3.1.12
Madsen/Otometrics Tymp-Link 1.0
Madsen/Otometrics Zodi-Link 3.0
Madsen/Otometrics Aurical Visible Speech 2.01.03
Maico Audiometry 3.0
MedRx Avant HIT 1.0
MedRx Avant A2D 2.0
MedRx Avant AUD 2.0
MedRx Avant REM Speech 2.01
Otovation Symphony 1.0
Siemens UNITY (Aud, HIA, Probe) 4.7
Siemens UNITY VO 2.0

Autres modules:

3shape Scanner Module 1.0.0.2 **
GN ReSound Pro Counsel 1.3 **
Interton ProFiler 1.2 **

Systèmes bureautiques:

AMPAREX 1.5.51.10
ASEGO asego.net 09/2008
AuditData Mirage 2.5
AuditData Auditbase System 4.14.04
Computers Unlimited TIMS for Audiology 5.0.3
EMAR Lægesystem 10.0.237.304
Fischbauer Software FS-Akustik 2.13
IPN Systemhaus AkuWin Office NG 2.4
Starkey Laboratories ProHear 6.3.82
Widex InfoTrack 1.2

Congrès et événements

54. International Hörgeräteakustiker-Kongress Nuremberg, Allemagne	21-23 Octobre 2009 --
AudiologyNOW! San Diego, California USA	14-17 Avril 2010 --

Le coin support

Lors du lancement de NOAHlink, HIMSA recommandait et supportait l'utilisation de NOAHlink avec la pile Bluetooth de Widcomm. Aujourd'hui encore, les nouveaux NOAHlinks installés sur Windows XP sont configurés pour utiliser par défaut les pilotes Ezurio et la pile Bluetooth de Widcomm. Cependant, les nouvelles installations Vista de NOAHlink utilisent la pile Bluetooth de Microsoft. La pile de Microsoft offre certains avantages :

1. Pré-installée sur tous les ordinateurs XP/Vista
2. Installation "prête à l'emploi", aucun pilote à installer manuellement

Dans le courant de cette année, HIMSA a l'intention de conseiller par défaut l'utilisation de la pile Bluetooth de Microsoft sur toutes les installations NOAHlink. Pour en savoir plus sur l'utilisation de la pile Bluetooth de Microsoft, veuillez consulter le site :

www.himsa.com/default.aspx?tabid=687

Contactez HIMSA

Monde entier: HIMSA II K/S
Lyngbyvej 28, 1th
DK-2100 Copenhague Ø
Tel.: +45 39 16 22 00
Fax: +45 39 16 22 16
E-mail: himsa@himsa.dk

Amérique du nord: HIMSA, Inc.
2550 University Ave. West,
Ste 241N
St. Paul, MN 55114
Tél.: 1-651-644-2921
Fax: 1-651-644-3046
E-mail: himsa@himsa.com

Site internet:
www.himsa.com

La lettre d'information, HIMSA News, paraît trimestriellement et est publiée par HIMSA. La date de clôture de cette édition était le 23 juin 2009. N'hésitez pas à faire parvenir vos commentaires et suggestions à HIMSA II K/S au Danemark à l'adresse suivante: himsa@himsa.dk.

HIMSA